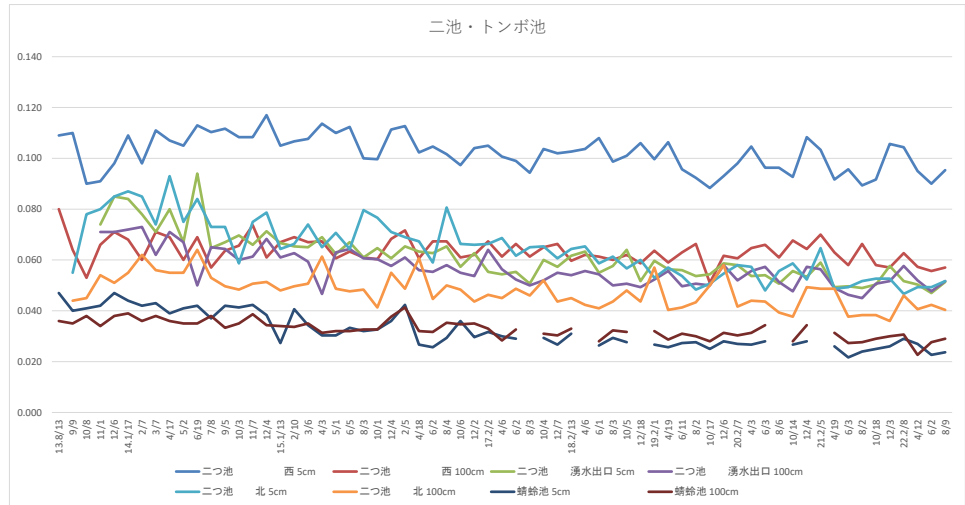
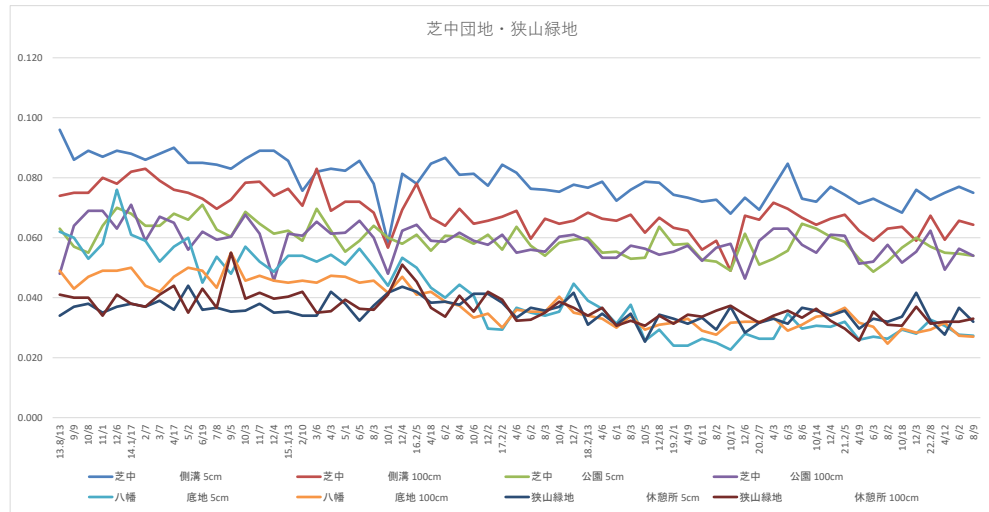


放射線測定結果

單位: μ sv/h

[illegible]

測定器：HORIBA PA-1000 R a d i ; 平均値

2014年6/9; No3、11/7、2016年2/5、8/4; No2、2018年4/6 No4 以外No1測定器;平成29年8/3トンボ池メテ、30年4/6トンボ池メテで測定無;2020年8月6日、2021年2月3日トンボ池メンテで測定無。

2021年6月より新測定器(N03)で測定。